



### KFZ-Bordnetznachbildung NNBM 8124-400 Single path vehicle AMN (LISN) NNBM 8124-400



#### Anwendung:


Die unsymmetrische, einpolige Bordnetznachbildung NNBM 8124-400 kann zum Messen der Störspannung im HF-VHF-Bereich von 0,1 MHz bis ca. 150 MHz auf Bordnetzen (z.B. KFZ, Flugzeuge, Schiffe) verwendet werden oder auch für BCI Tests. Auch Transientenmessungen nach ISO 7637-2 sind möglich. Die Nachbildungsimpedanz entspricht den Anforderungen aus CISPR 16-1-2 und CISPR 25 mit  $(5\mu\text{H} + 1 \text{ Ohm}) \parallel 50 \text{ Ohm}$ . Die zulässige Dauerstromaufnahme des Prüflings beträgt 250 A. Kurzzeitig können über 500 A entnommen werden. Damit ist dieses Modell besonders für die Bereiche elektrische Energiespeicher, Elektromobilität und Hybridantriebe interessant. Die hohe Spannungsfestigkeit unterstreicht dies. Sollen dauerhaft Ströme  $> 250 \text{ A}$  entnommen werden so kann dies durch externe Belüftung realisiert werden. Der Prüfling wird an den Flügelklemmen der Frontplatte angeschlossen. Die Speisung erfolgt auf der Rückseite.

#### Application:

The main application of the unsymmetrical single path AMN (artificial mains network) NNBM 8124-400 is the measurement of interference voltage in vehicles, aircrafts and ships within the HF-VHF range 0.1 – 150 MHz. The NNBM 8124-400 can also be used for bulk current injection (BCI) testing or for transient measurements according to ISO 7637-2. The impedance characteristic is implemented according to CISPR 16-1-2 and CISPR 25 with  $(5\mu\text{H} + 1 \text{ Ohm}) \parallel 50 \text{ Ohm}$ . The continuous current rating is 250 A, for a short time more than 500 A are possible. With its high voltage and current specification this automotive LISN fits well for electric vehicle (EV), hybrid drive and on-board battery electronics testing. The EuT is connected to the wing terminals at the front panel. The mains terminals are on the backside.

| Technische Daten:                                     |   | Specifications:  |
|---|---|--|
| Frequenzbereich:                                      | 0.1 - 110 (150) MHz   | Frequency range:                                       |
| Max. Dauerbetriebsstrom:                              | 250 A   | Max. cont. current:                                    |
| Max. Strom (kurzzeitig):                              | 500 A   | Max. current (short-period):                           |
| Max. Netzspannung (DC):                               | 1000 V  | Max. voltage (DC):                                     |
| Max. Netzspannung (50/60 Hz AC):                      | 400 V   | Max. voltage (AC 50/60 Hz):                            |
| Max. Netzspannung (400 Hz AC):                        | 300 V   | Max. voltage (AC 400 Hz):                              |
| Nachbildungs-Impedanz:                                | $(5\mu\text{H} + 1\text{ Ohm}) \parallel 50\text{ Ohm}$<br>(+/- 10 %) | Impedance at EuT-terminals:                            |
| DC-Widerstand der Spulenwindung:                      | < 1.3 mΩ  | DC resistance mains-EuT:                               |
| Spulenimpedanz (50 Hz):                               | 2 mΩ  | Coil impedance (50 Hz):                                |
| Spulenimpedanz (400 Hz):                              | 12.6 mΩ   | Coil impedance (400 Hz):                               |
| Prüflingsanschluss: Flügelklemmen abschraubbar:       | 16 mm   | EuT connectors: Wing terminals unscrewable:            |
| Abmessungen, Gehäuse ohne Klemmen (B x H x T):        | 220 x 225 x 260 mm  | Dimensions housing without terminals (W x H x D):      |
| Abmessungen, Gehäuse mit Klemmen maximal (B x H x T): | 220 x 225 x 450 mm  | Dimensions housing with terminals maximum (W x H x D): |
| Gewicht:  | 6.0 kg  | Weight:  |

**Prinzipschaltbild der NNBM 8124-400**  
**Simplified circuitry of the NNBM 8124-400**

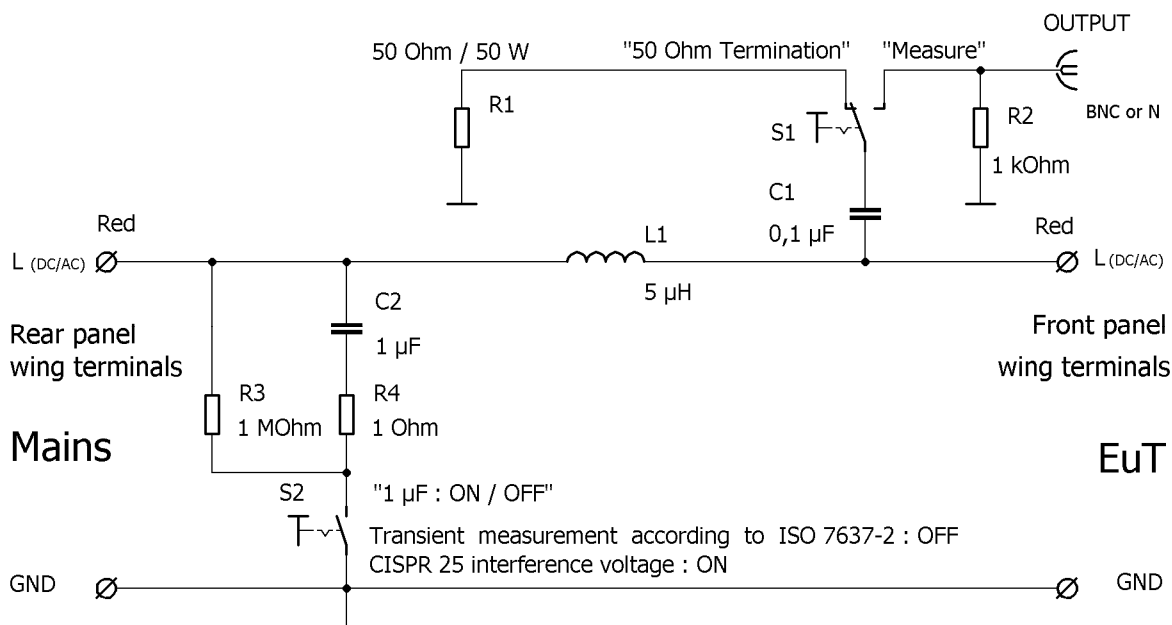

**Störspannungsmessung nach CISPR 25:**

Der Netzanschluss erfolgt auf der Rückseite. **Der dort befindliche 1µF-Kondensator muss** zur besseren Filterung externer Störungen und für beste Isolationswerte **eingeschaltet werden**. Der Prüfling wird an der Vorderseite angeschlossen. Die HF-Störspannung, die der Prüfling emittiert, wird an die BNC-Buchse angekoppelt, wo sie mit einem Messempfänger gemessen werden kann. Der Schalter auf der Vorderseite muss hierzu auf „Measure“ gestellt werden. In den meisten Fällen ist für die Hin- und die Rückleitung eine eigenständige LISN zu verwenden. Die Hin- und die Rückleitung wird dann jeweils über die roten Flügelklemmen der NNBM 8124-400 gelegt. Die Leitung, die gerade mit dem Messempfänger verbunden ist, wird auf „Measure“ geschaltet. Die andere Leitung muss mit 50 Ohm abgeschlossen werden. Dies geschieht durch Einstellen des Schalters auf „50 Ohm Termination“. Die HF-Bezugsfläche wird bei beiden AMNs mit den GND-Klemmen verbunden.

Die 4 mm Laborbuchse an der Vorder- und Rückseite der NNBM 8124-400 und die aus Aluminium-Flachmaterial gefertigten Standfüße sind mit den GND-Klemmen elektrisch auf gleichem Potential.

**Einkopplung von Störströmen mit einer Stromzange (BCI-Tests):**

Für Messungen mit eingespeisten Störströmen wird die NNBM 8124-400 zusammen mit geeigneten Stromzangen verwendet. Die maximale Dauer-Belastbarkeit der eingebauten Hochlast-Widerstände beträgt 50 W (an den Prüfling-klemmen). Bei einer HF-Dauerbelastung von 50 W erwärmt sich das Gehäuse der Netznachbildung auf ca. 60 °C an der Frontplatte. Bei Berührungen des Gehäuses muss mit hohen Temperaturen gerechnet werden. Eine ausreichend gute Luftzirkulation zur Unterstützung der Wärmeabfuhr wird angeraten. Unter keinen Umständen darf die Luftzirkulation der Netznachbildung behindert werden, die Lochbleche an Deckel und Boden dürfen keinesfalls abgedeckt werden. Bei Einkopplung von Störgrößen können unter Umständen Gefährdungen durch hohe Feldstärken und Temperaturen (Brandgefahr!) auftreten, daher dürfen derartige Tests nur von fachlich qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Die einschlägigen Sicherheitsvorschriften müssen beachtet werden. Im Regelfall wird bei BCI-Tests die Schalterstellung

**Interference voltage measurements acc. CISPR 25:**

*Mains is connected at the back side. **The 1µF capacitor must be switched on** to filter external disturbance and to provide best isolation values. The DuT is connected to the front panel. The disturbance voltage is coupled to the BNC connector where it can be measured with an EMI receiver. For this purpose the switch at the front panel must be switched to “Measure”. In most cases one AMN has to be used for each line (e.g. + and -). The RF-reference ground must be connected to both GND-terminals. The red terminal of one NNBM 8124-400 must be connected to the + line and the red terminal of the other NNBM 8124-400 must be connected to the – line. The LISN that is connected to the line that is being measured has to be switched to “Measure”. The other one has to be terminated with 50 Ohms by switching the front panel switch to “50 Ohm termination”.*

*The 4 mm laboratory jacks at front- and back panel and the flat aluminium feet are electrically connected to the GND-terminals.*

**Immunity tests with bulk current injection (BCI-tests):**

*The NNBM 8124-400 can be used for bulk current injection tests utilizing a current injection clamp. The maximum continuous power rating is 50 W (at the EuT-terminals). Under continuous load at 50 W the LISN housing heats up to approx. 60 °C at the front panel. The operator must be aware of high temperatures. The top and bottom perforated metal plates of the NNBM 8124-400 **must not be covered under any circumstances!** A sufficient air-circulation must be provided at any time to avoid overheating of the LISN.*

*During bulk current injection tests dangers may arise by high field strengths and temperatures (fire hazard!), therefore these tests must be performed by qualified personnel only! The relevant safety precautions must be considered! Usually the switch position “50 Ohm Termination” is used for BCI-tests. The power injected at the EuT-terminals is converted to heat inside the 50 Ohm / 50 W resistors. Please note: If the LISN is switched to “Measure”, the injected RF-Power will be routed from*

"50 Ohm Termination" (50 Ohm Abschluss) benutzt. Die eingekoppelte Störleistung wird dann im 50 Ohm 50 Watt Abschlusswiderstand der Netznachbildung in Wärme umgewandelt. Bitte beachten: In Schalterstellung "Measure" (Messen) wird die an den Prüflingsklemmen eingekoppelte HF-Leistung ungedämpft an die BNC-Buchse weitergeleitet, eventuell angeschlossene Messgeräte könnten zerstört werden!

**Transientenmessungen n. ISO 7637-2:**

Weiterhin findet die NNBM 8124-400 Anwendung zur Messung von Transienten nach ISO 7637-2. Um Transienten nicht kurzzuschließen, **muss der netzseitige 1 µF Kondensator hierzu abgeschaltet werden!**

**Hinweis:**

Wegen hoher kapazitiver Ableitströme (Bemessung der Ableitkondensatoren nach CISPR) ist in der Regel ein Betrieb mit Fehlerstromschutzschalter in der Gebäudeinstallation (bzw. im Messlabor) **nicht** möglich. Entweder muss eine Sondersteckdose ohne FI-Schalter und entsprechender Beschriftung installiert werden, oder es wird ein Netz-Trenntransformator 1:1 eingesetzt.

In jedem Fall beachten:

**Die Netznachbildung muss vor der Netzverbindung an Schutz Erde gelegt werden.** Anwender der Netznachbildung sind entsprechend einzuweisen.

**Betrieb mit sehr hohen Strömen:**

Die NNBM 8124-400 ist nicht mit Lüftern ausgestattet. Wenn sie auf den eigenen Aluminiumfüßen steht und somit nur ein kleiner Zwischenraum zum Einströmen von Frischluft unter der NNBM 8124-400 verbleibt, so kann sie mit dauerhaft 250 A betrieben werden. Der maximal mögliche Dauerstrom kann deutlich gesteigert werden, wenn für Kühlung gesorgt wird. Dies kann durch einfaches Hochstellen der LISN geschehen. Dabei muss der Freiraum unter der LISN vergrößert werden, ohne das Boden- oder Deckellochblech abzudecken. Die Erwärmungskurven am Ende dieses Datenblattes wurden ohne jegliche Maßnahme zur Verbesserung der Kühlung aufgenommen. Die Temperatur an der Oberfläche der eingebauten Luftspule sollte 160 °C nicht überschreiten.

*the EuT terminals straight to the BNC-output without any attenuation. Eventually connected RF-measuring equipment might be damaged!*

**Transient measurements acc. ISO 7637-2:**

*The NNBM 8124-400 can be used to measure transients according to ISO 7637-2. The **1 µF capacitor on the mains side could short transients and must be switched off** for this purpose.*

**Notice:**

*Since the circuitry is dimensioned according to CISPR regulations, high leakage currents to ground do occur. Normally it is not possible to use a LISN on power lines connected to ground current safety switches (they disconnect power due to excessive ground current). Either a special power line outlet which is not connected to the ground current safety switch must be installed (warning label required!), or an isolating power line transformer 1:1 must be used.*


*In any case, **ground-connect LISN before connecting to power line.** Precise safety instructions must be provided to any user of the LISN.*

**Continuous high current operation:**


*The NNBM 8124-400 is not equipped with cooling fans. If the unit is put on its own aluminium feet there is only a small slot as air intake. Under these circumstances the LISN can be used with a current of 250 A continuously. The maximum allowable current can be increased remarkably by propping the LISN up in a way that the air intake slot becomes larger. The perforated sheets on bottom and top must not be covered by the props. The temperature curves at the end of this data sheet have been measured without any cooling arrangements. The surface temperature at the built in air core inductor should not exceed 160 °C.*



Impedanz an den Prüflingsklemmen (Spezialadapter erforderlich),  
BNC mit 50 Ohm Abschluss, Speiseklemmen kurzgeschlossen  
*Impedance at EuT-terminals (adapter required),  
BNC-port is terminated with 50 Ohm, short on the mains terminals*

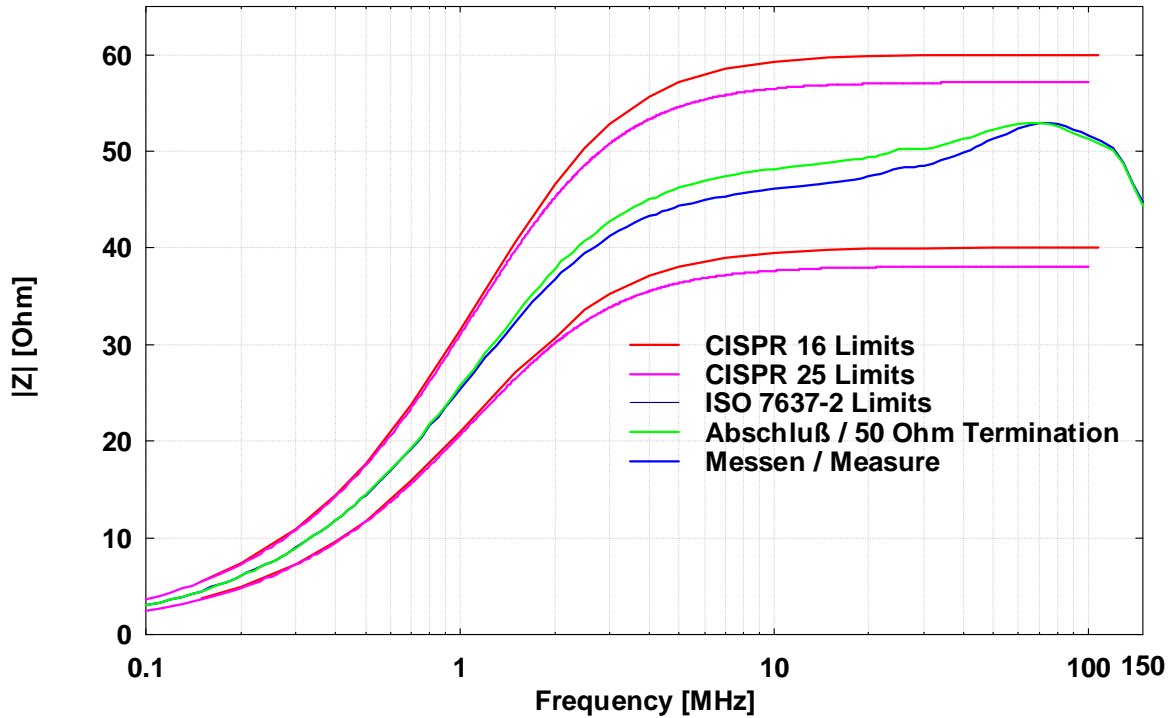


Phase an den Prüflingsklemmen (Spezialadapter erforderlich),  
BNC mit 50 Ω Abschluss, Speiseklemmen kurzgeschlossen  
*Phase at EuT-terminals (adapter required),  
BNC-port is terminated with 50 Ohm, short on the mains terminals*

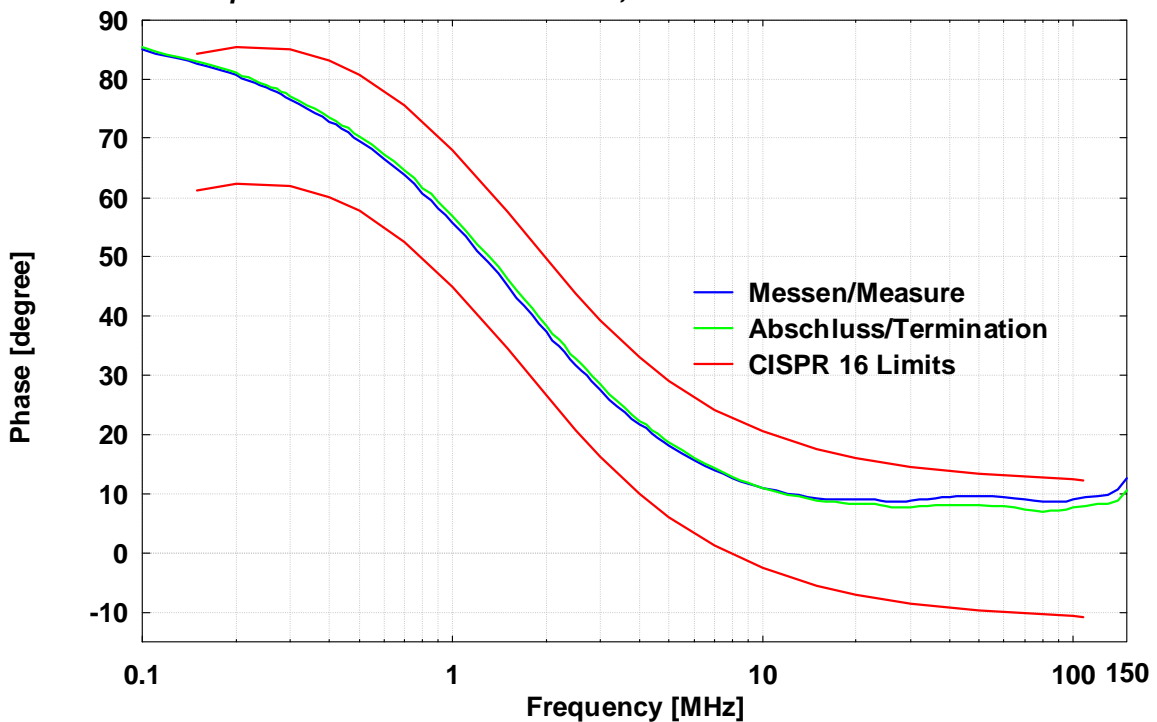




Phase an den Prüflingsklemmen (Spezialadapter erforderlich),  
BNC mit 50  $\Omega$  Abschluss, Speiseklemmen offen  
*Phase at EuT-terminals (adapter required),  
BNC-port is terminated with 50 Ohm, mains terminals open*

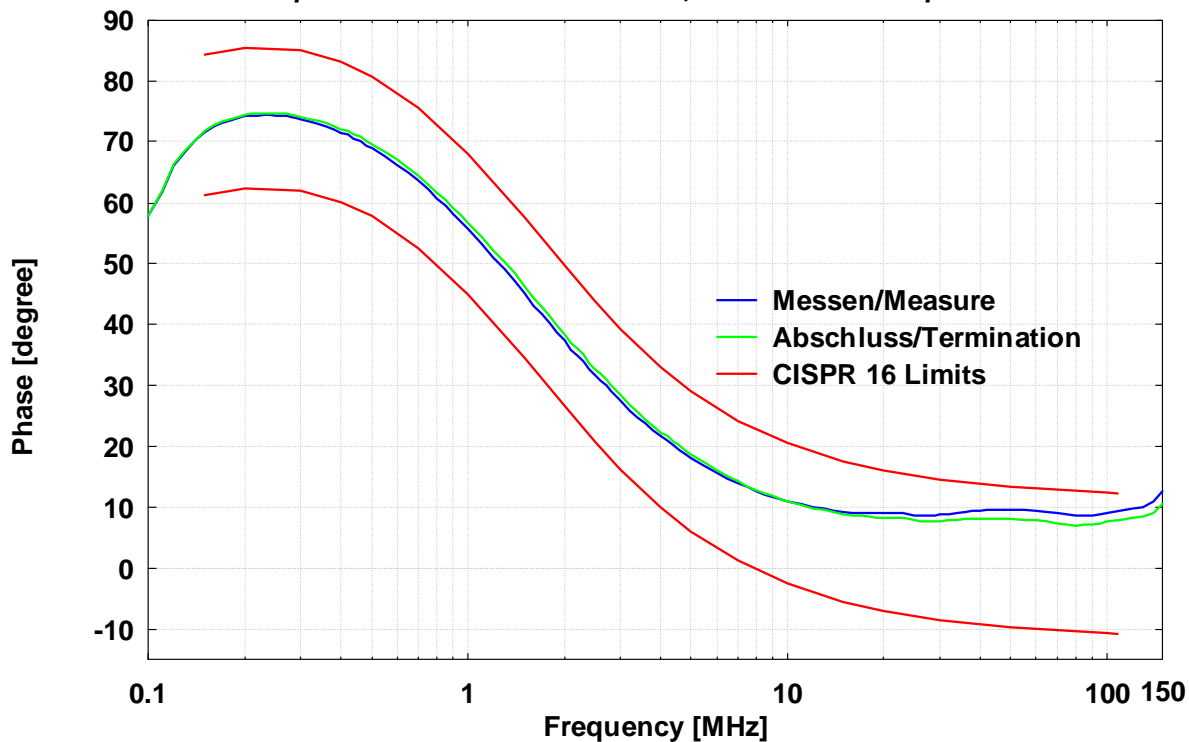

Spannungsteilungsmaß Prüflingsklemmen - BNC (Spezialadapter erforderlich)  
*Voltage division ratio EuT-terminals to BNC (adapter required)*

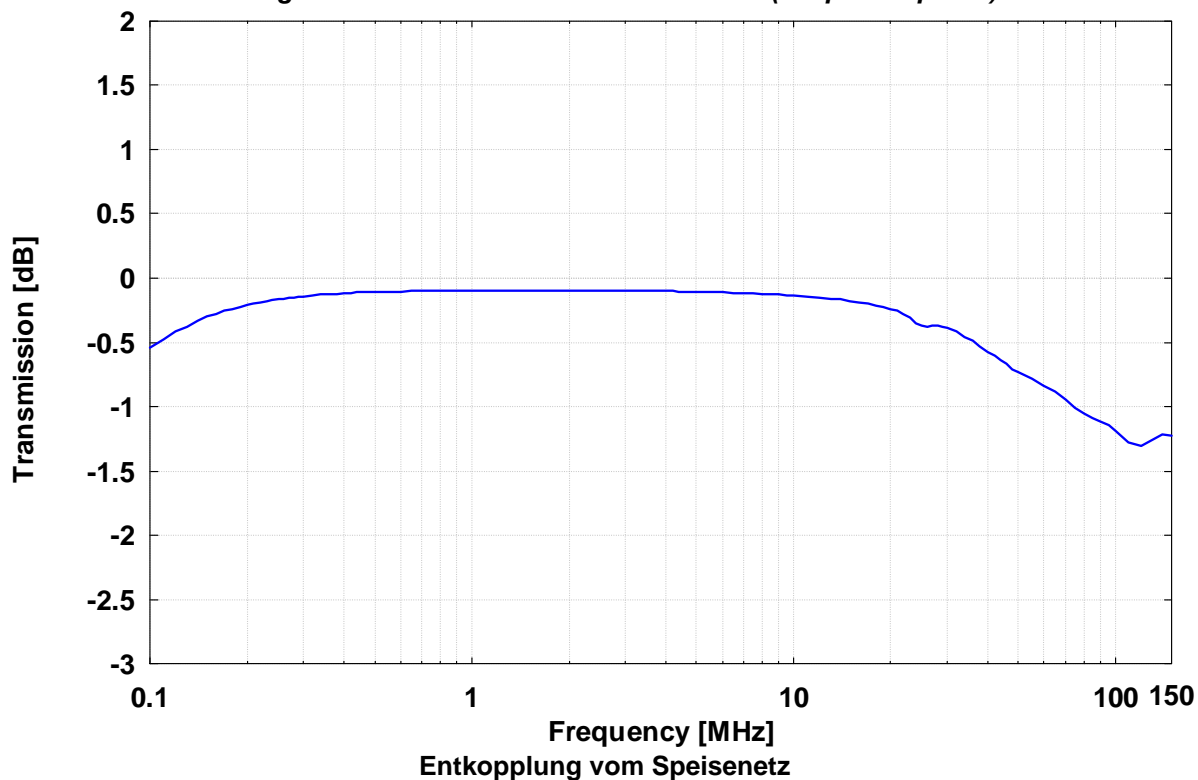

Entkopplung vom Speisernetz

